



met  
Blood Sugar  
Mentor™

## Introductie van het OneTouch Verio Reflect® Systeem

Laten we patiënten helpen  
om verder te kijken dan hun  
bloedglucosewaarden

Connecteert met OneTouch Reveal®, één van de  
meest gedownloade diabetes apps ter wereld.\*\*



**ONETOUCH®**  
every touch is a step forward™

\* Bloedsuiker Coach

\*\* Research2Guidance Diabetes App Marktgegevens Q1-Q4, 2017.

iOS is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. App StoreSM is een dienstmerk van Apple Inc. AndroidTM en Google Play zijn handelsmerken van Google Inc.

## Bloedglucoseresultaten interpreteren en ernaar handelen

Gebrek aan begrip




Gebrek aan actie




Leidt tot slechte controle



>70% was niet in staat om een hyperglycemie te herkennen<sup>1</sup>

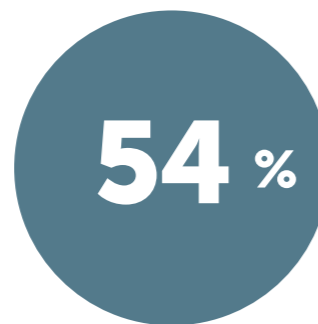

54% op insuliner therapie reageerde niet regelmatig op hoge of lage bloedglucoseresultaten<sup>2</sup>

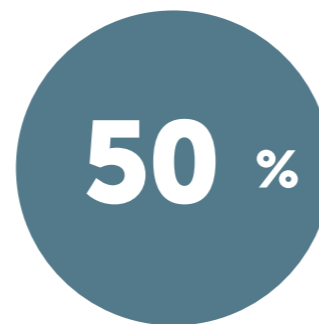

50% had zijn glycemie slecht onder controle<sup>3</sup>

## Hoe kunnen we uw patiënten helpen om hun diabetes zelfmanagement te verbeteren?

1 Evans JMM, et al. Self-monitoring of blood glucose in type 2 diabetes: patients' perceptions of 'high' readings. Diabetes Res Clin Practice 2013;102(1):e5- e7. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.diabres.2013.07.011. Based on results of 207 non-insulin using patients, 28% correctly identified a blood glucose reading of >235 mg/dL as a high result.

2 Polonsky WH, et al. A survey of blood glucose monitoring patients with type 2 diabetes: are recommendations of health care professionals followed? Curr Med Res Opin 2011;27 (suppl 3):31-37.

3 Gopinath B, et al. Study of factors associated with poor glycaemic control in Type-2 Diabetes patients. Global Journal of Medicine and Public Health 2013;2(2):ISSN# - 2277-9604. In a clinical study of 500 patients, conducted in India, 393 had poor glycaemic control, (HbA1c >= 7%)

## NIEUW OneTouch Verio Reflect®

Bloedglucoseresultaten kunnen problemen aangeven, maar geen oplossingen. Wat als uw patiënten verder konden kijken dan enkel een cijfer zodat ze hun waarden beter begrijpen en onmiddellijk actie kunnen ondernemen?

De OneTouch Verio Reflect® meter is uitgerust met Bloedsuiker Coach\* die patiënten gepersonaliseerde begeleiding, inzicht, en motivatie biedt, zodat zij actie kunnen ondernemen om hoge en lage waarden te vermijden.\*\*



## Bloedsuiker Coach\* – boodschappen onmiddellijk op het meterscherm

Begeleiding



Biedt real-time begeleiding om patiënten te helpen hypo's en hypers te vermijden.

Inzicht



Help patiënten de impact van voeding, activiteit en medicatie op hun glucose te begrijpen.

Motivatie




Motiveert patiënten om op schema te blijven hun diabetesdoelstellingen te behalen.

\* Bloedsuiker Coach / Blood Sugar Mentor™

\*\* Beslissingen over de behandeling moeten gebaseerd zijn op het numerieke resultaat en de aanbevelingen van de professionele zorgverlener.

## De Dynamische ColourSure® Bereikindicator verwittigt patiënten als zij in de buurt van een hypo of hyper komen.


- Kleur-gecodeerde hulpmiddelen verbeteren het zelfmanagement
- Kan helpen om hypo's en hypers te vermijden

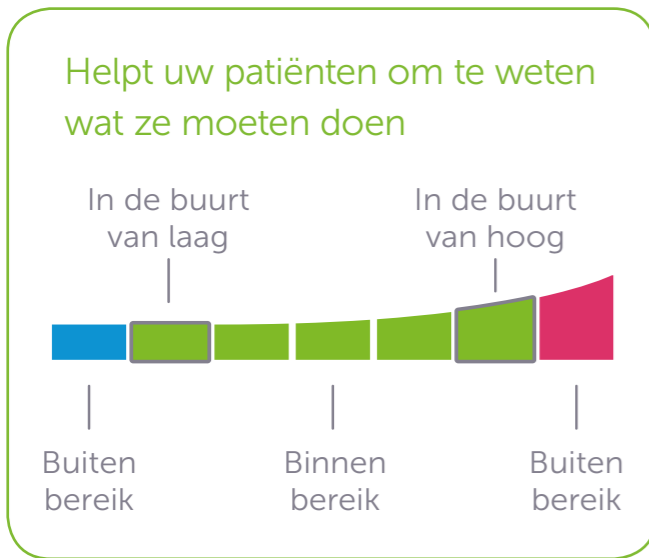

ColourSure®  
PLUS

## Nog meer inzicht als patiënten connecteren met de OneTouch Reveal® mobiele app

Helpt patiënten begrijpen wat de impact van voeding, activiteit en medicatie is op hun bloedglucose.\*

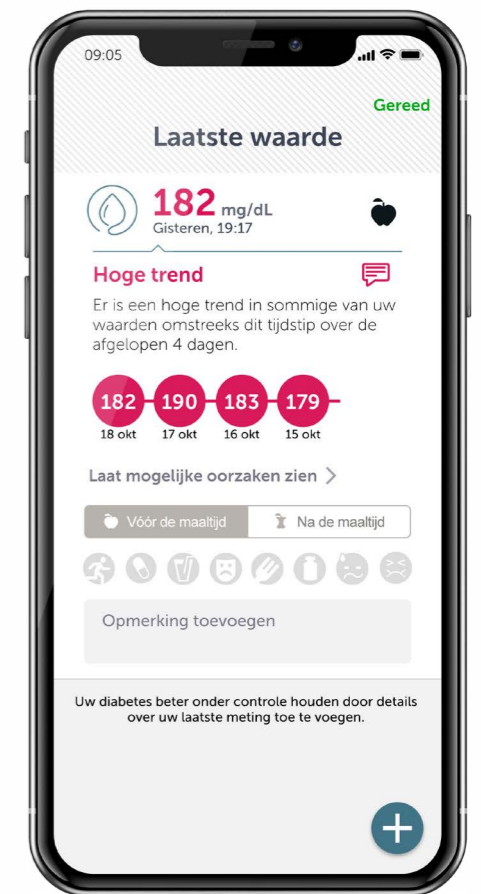

87% van de zorgverleners gingen akkoord dat de Dynamische ColourSure® Bereikindicator het gemakkelijker zou kunnen maken om patiënten aan te leren hoe ze hun bloedglucose-resultaten moeten interpreteren.\*

\* Gebaseerd op een internationale enquête van 2018 waarbij gebruik werd gemaakt van een gesimuleerd model van de OneTouch Verio Reflect® meter en de OneTouch Reveal® mobiele app. 87% van de 355 professionele zorgverleners ging akkoord.



83% van de mensen verkozen het OneTouch Verio Reflect® systeem en de OneTouch Reveal® mobiele app boven hun afzonderlijke meter.\*\*



\* Beslissingen over de behandeling moeten gebaseerd zijn op het numerieke resultaat en de aanbevelingen van de professionele zorgverlener.

\*\* Gebaseerd op een Enquête van 2018 uitgevoerd in Groot-Brittannië met een gesimuleerd model van de OneTouch Verio Reflect® meter en de OneTouch Reveal® mobiele app. 83% van 133 van de patiënten ging akkoord.

# NIEUW OneTouch Verio Reflect® Systeem

85% van de professionele zorgverleners gelooft dat het systeem hun patiënten zou kunnen helpen om vol vertrouwen vooruitgang te boeken bij het managen van hun bloedsuiker.\*



OneTouch Verio®  
teststrips

7 jaar bewezen  
precisie

OneTouch® Delica®  
Plus prikpen

Vrijwel pijnloos  
testen\*\*



## Vragen?



[www.OneTouch.be](http://www.OneTouch.be)



Bel de gratis OneTouch lijn op 0800 15325

**ONETOUCH®**  
every touch is a step forward™

\* Gebaseerd op een Enquête van 2018 uitgevoerd in Groot-Brittannië met een gesimuleerd model van de OneTouch Verio Reflect® meter en de OneTouch Reveal® mobiele app, 85% van 355 van de professionele zorgverleners ging akkoord.

\*\* Bij de deelnemers die een voorkeur hebben geuit en die ervaring hadden met de 30G OneTouch® Delica® prikpen en minstens 1 andere prikpen, 72% van de respondenten ging akkoord. Gebaseerd op een online enquête uitgevoerd in de VS in 2016.

† EN ISO 15197:2015 In vitro diagnostische beproevingsystemen - eisen voor bloedglucosemonitoringsystemen voor zelftesten voor het reguleren van diabetes mellitus. (ISO 15197:2013)